



DGで均一サイズのAGMを自動・大量作製

On-chip Droplet Generator (DG) で作製した80 μm 程度のAGM

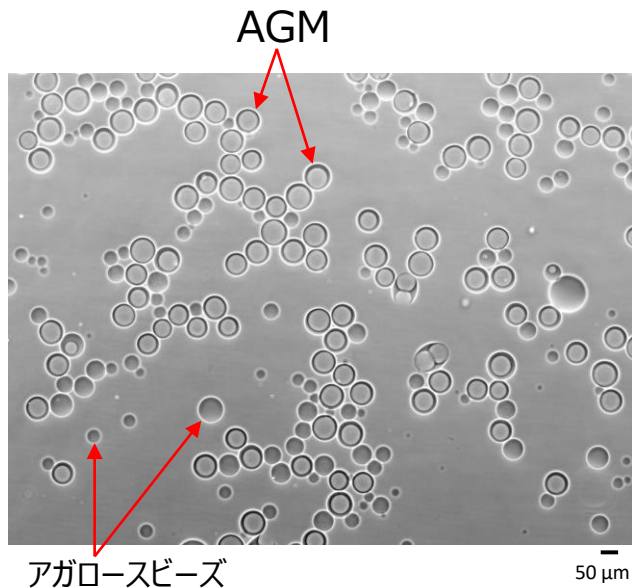

DGで作製したAGMの位相差顕微鏡写真

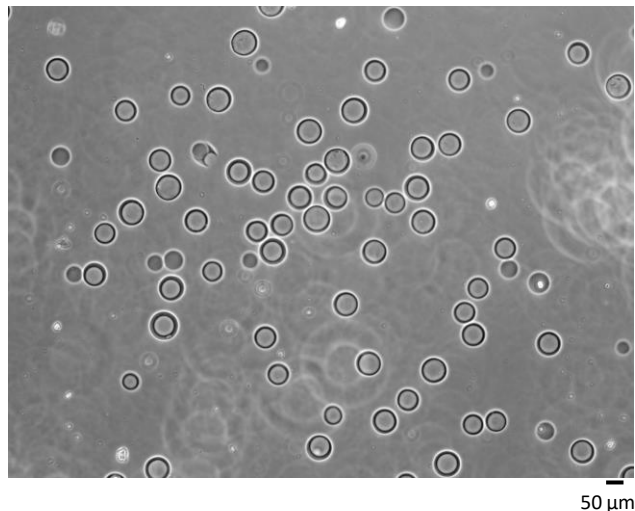

DGで作製後、セルストレーナで30 μm 以下のアガロースビーズを除去した、AGMの位相差顕微鏡写真

[AGM™試薬キット製造販売元](#)

[株式会社東陽テクニカ](#)

[ワン・テクノロジーズ・カンパニー](#)